ケアスロープ® JC

スロープパーツB（CS−JC）
メンテナンスマニュアル

1．スロープパーツBの構造・部品名称
2．日常の管理と手入れ方法
3．滑り止めテープの張り替え方法
4．アジャスターゴムリング交換方法
5．エッジモールの交換方法

ケアメディックス株式会社

2019/8月

1．スロープパーツBの構造・部品名称

製 品 名	スロープパーツB
品　　番	CS-JC
重　　量	約22kg
耐 荷 重	300kg
サ イ ズ	幅 107cm × 長さ 107cm × 高さ （落下防止柵含54cm～74cm）
材　　質	アルミ・スチール・ステンレス・樹脂・ゴム

部品名称	材　質	数　量
天　　板	アルミ・樹脂	左右各1枚
フレーム	アルミ	1個
アジャースター	スチール・ゴム	4個
落下防止柵（大）	アルミ	1個
落下防止柵（小）	アルミ	1個
フラップ	アルミ	1枚

スロープパーツB（CS-JC）　部位名称

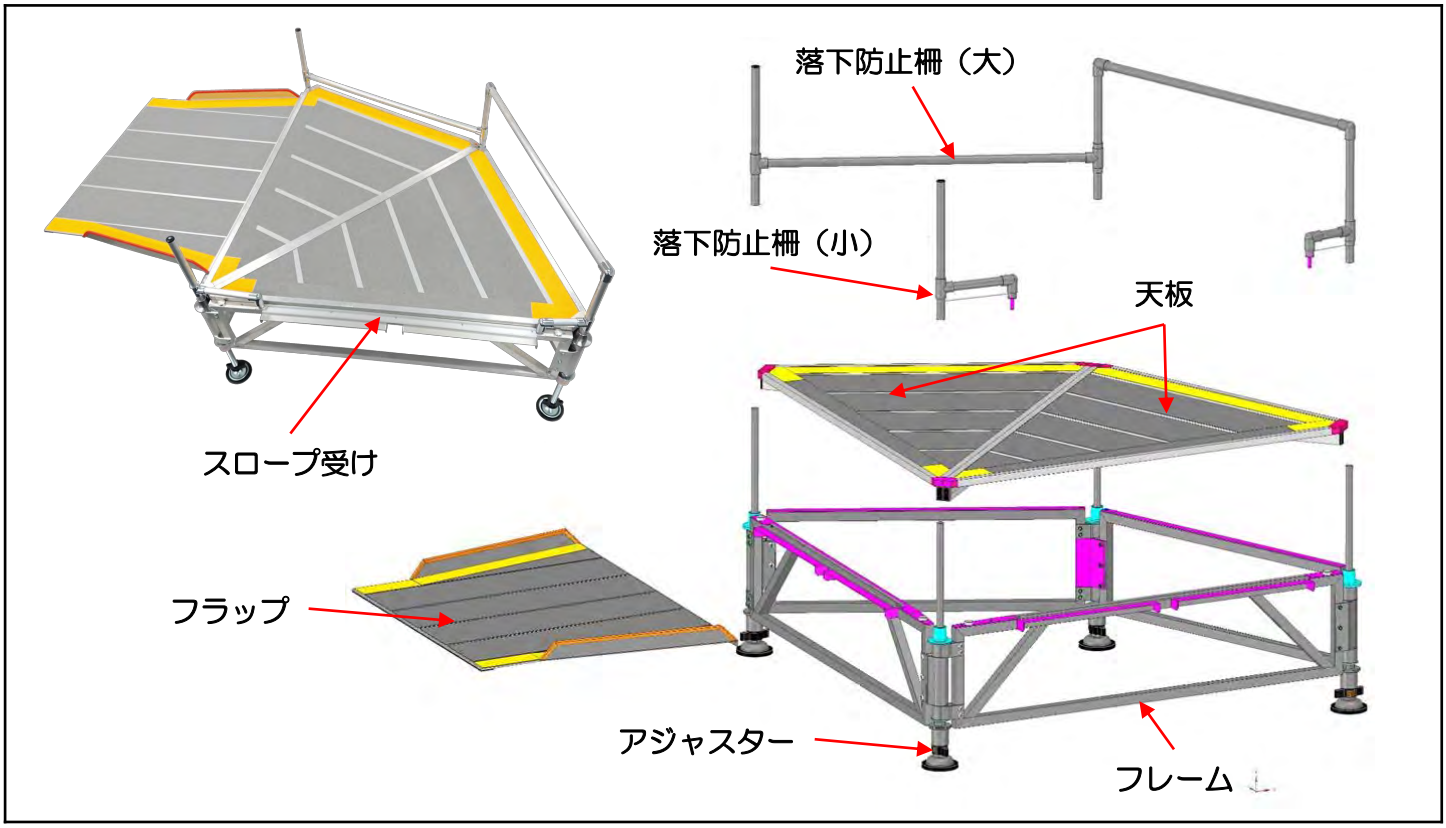

2．日常の管理と手入れ方法

・使用前に点検シートの項目を確認してください。
・スロープパーツB（CS-JC）の破損や摩耗などの異常を発見したときは、
　使用を中止し、お求めいただいた販売店にご連絡ください。
・分解や改造はしないでください。事故の原因となります。
・サビ防止の為、定期的にアジャスター部、アジャスター受け部に油等をさしてください。
　（メンテナンス後と、貸し出し前を推奨）

点検シート

点検項目	部品写真	点検の基準	チェック欄
外　観		・泥汚れがないこと。 ・油汚れがないこと。	
フレーム		・変形、破損がないこと。	
天　板		・変形、破損がないこと。 ・すべり止めシート剥がれ、表面の汚れ、摩耗がないこと。	
フラップ		・変形、破損がないこと。 ・すべり止めシート剥がれ、表面の汚れ、摩耗がないこと。 ・エジモール変形、破損、剥がれがないこと。	
落下防止柵（大）		・変形、破損、ゆがみがないこと。 ・ビスの緩みがないこと。	
落下防止柵（小）		・変形、破損、ゆがみがないこと。 ・ビスの緩みがないこと。	
アジャスター		・変形、破損がないこと。 ※メンテナンス後、貸出し前に油等をさしてください。	
スロープ受け アルミレール		・変形、破損、ゆがみがないこと。 ・ビスの緩みがないこと。	
アジャスター用 ゴムリング		・変形、破損がないこと。	

3．滑り止めテープの張り替え方法

滑り止めテープの汚れ、剥がれが生じた場合以下の通りに交換してください。

1）汚れ、剥がれのある滑り止めテープを剥がします。
2）表面を拭き、汚れを除きます。
3）滑り止めの離型紙を剥がし、端から徐々に貼り付けます。
4）貼付け後ローラーで圧着します。

4．アジャスターゴムリング交換方法

アジャスターゴムリングは破損が生じた場合以下の通りに交換してください。

1）破損したゴムリングを外します。
2）汚れを拭き取ります。
3）新しいゴムリングを取付ます。

5．エッジモールの交換方法

エッジモールの剥がれ、破損が生じた場合以下の通りに交換してください。

1）エッジ端部を沿うようにカットの刃を入れエッジモールを切断します。
2）残ったエジモールをむらなく剥がします。
3）エッジ部にエッジモールをはめ込み、片方ずつ接着剤を塗布し、圧着してください。

≪修理に関するお問い合わせ先≫

ケアメディックス株式会社
TEL：03-3837-0551　FAX：03-3837-0554

≪修理品の送り先住所≫

〒327-0041　栃木県佐野市免鳥町421-1
TEL：0283-27-3353
祖峰企画株式会社　佐野工場　修理担当者宛

≪修理について≫

※消耗部以外の本体修理は当社にご依頼お願いします。
※修理費につきましては販売店、または当社までお問い合わせください。
※修理依頼の前には必ずご連絡をお願い致します。